




Longtemps **ATTENDUS,**
enfin **ARRIVÉS !**

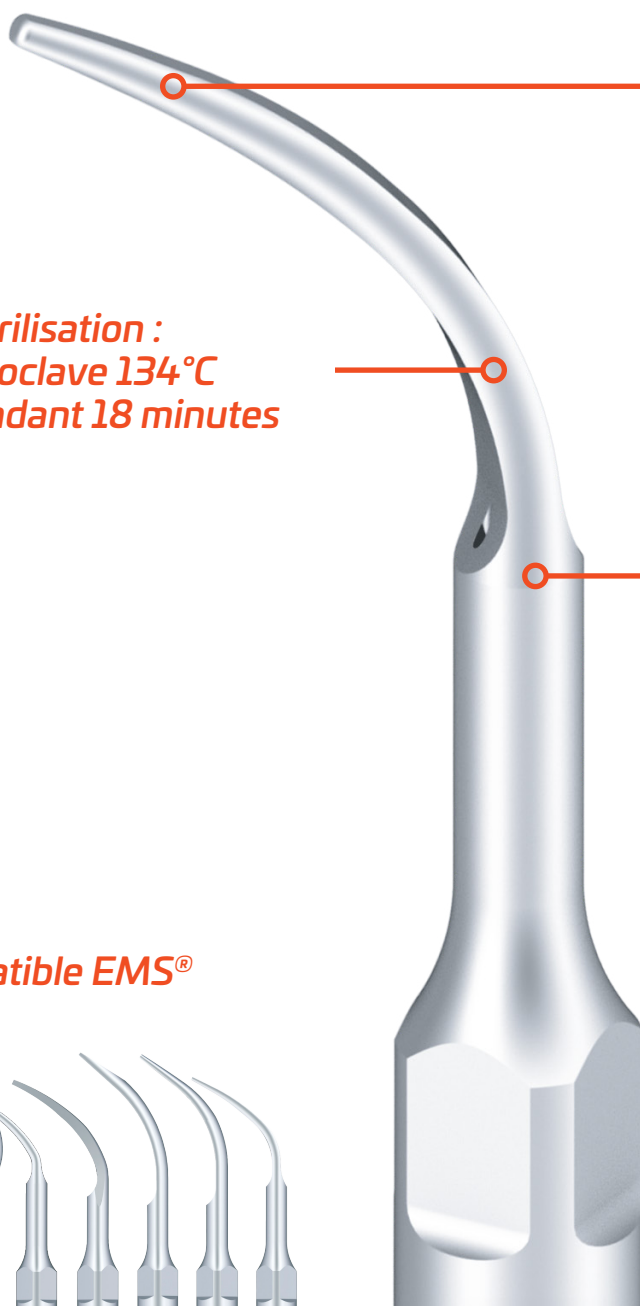



*En acier inoxydable
de très haute qualité*

*Stérilisation :
autoclave 134°C
pendant 18 minutes*

Très résistants

Compatible EMS®

Compatible SATELEC®

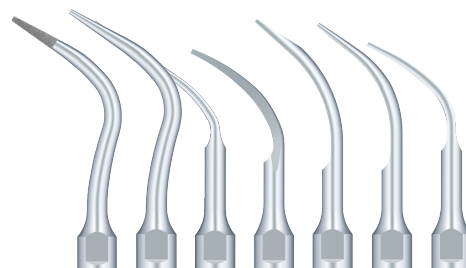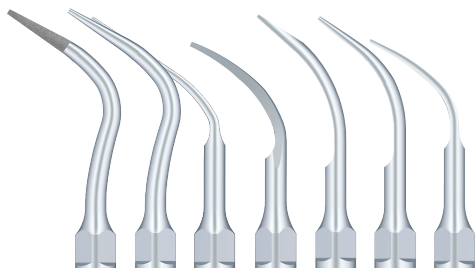

Découvrez les Inserts Ultrasons **3TECH** qui s'adaptent à tous types de domaines
PROPHYLAXIE, PARONDONTIE et ENDODONTIE

INSERTS



		MODÈLE	Référence	INDICATION
UNIVERSEL		G4	3162349	Élimination des dépôts supragingivaux et interproximaux
		GD4	3162352	
		G5	3162350	Élimination des dépôts supragingivaux dans tous les quadrants
		GD5	3162353	
		G6	3162351	Élimination des dépôts supragingivaux volumineux
		GD6	3162354	

		MODÈLE	Référence	INDICATION
PARO		P1	3162355	Élimination des dépôts sous-gingivaux dans les poches peu profondes
		PD1	3162358	
		P3	3162356	Élimination des dépôts sous-gingivaux dans les poches profondes
		PD3	3162359	
		P4	3162357	Élimination des dépôts sous-gingivaux dans les poches peu profondes
		PD4	3162360	

		MODÈLE	Référence	INDICATION
ENDO		P4D	3162361	Insert à revêtement diamanté pour l'élargissement du canal radiculaire et l'accès aux limes
		PD4D	3162362	

3TECH vous offre
le meilleur rapport
qualité prix du marché

Produits complémentaires

EASY SCALER

L-28



SCALER HANDPIECE

L-28

Faites comme nous

ÉQUIPEZ-VOUS MALIN !

La garantie n'est valable que dans un délai de cent jours à date de facturation. La garantie s'applique à des produits non déballés et non utilisés. Les produits doivent être retournés à la société dans les emballages et suremballages d'origine et accompagnés du motif de la demande d'échange ou de remboursement et d'une photocopie d'un devis ou d'une facture d'achat après avoir obtenu un accord de retour sur le site dans le compte du client ou auprès du Service Clients. Dans tous les autres cas, la garantie ne pourra être appliquée. Dispositifs médicaux de classe IIa. Fabricant légal : GUILIN REFINE MEDICAL INSTRUMENT CO. DM classe IIa. Marquage CE 0123-TUV PRODUCT SERVICE. Photos non contractuelles.